

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كۆماری عێراق

ئەنجومەنی نوێنەران

نوسینگە بەدڵمانار

رێکان الشیخ صبیح عازی الحنشل

ئەندامی لیژنە ی دەستپاکی



لە عێراق

نواب

نائب

عازی الحنشل

النزاهة

سعد عیاد عیاد
دهام
١٧٧٧٤٤٦١٨١

العدد: ٤٥٩

التاريخ: ٢٠٢٦ / ٧ / ٢٢

السيد وزير الصحة المحترم

م/ استثناء

تحية طيبة ..

نرافق لكم طياً نسخة مصورة للطلب المقدم من قبل المواطن (سعد إبراهيم عجاج) والذي يروم من سيادتكم التفضل بالموافقة على استثنائه من شرط منح (القوطة) الخاصة لمرضى الصم التام للمرة الثانية ، وذلك بسبب تلف الأولى التي حصل عليها من وزارتك الموقرة .

تفضل سيادتكم بالاطلاع والموافقة على استثناء المومأ اليه وذلك لما يعانيه من ظروف مادية صعبة.

راجين تدخلكم الشخصي واعلامنا ... مع التقدير .

المرفقات :

- نسخة مصورة من اصل الطلب .
- التقارير الطبية.

التائب

رێکان الشیخ صبیح عازی الحنشل

عضو لجنة النزاهة
الدورة السادسة

٢٠٢٦ / ٧ / ٢٢

نسخة الى :

- الأرشيف للتأشير والحفظ .

السيد مهدي وزير الصحة المحترم

م/استثناء


تحية وتقدير ...

أني المواطن (سعد إبراهيم عجاج) من أهالي مدينة الموصل أتقدم لمعاليكم بطاب الحصول على (قوقعة) والخاصة بمرضى الصمم حيث أنني سبق وأن حصلت على واحدة لابني (علي) البالغ (4) أربعة سنوات والمصاب بالصمم التام من وزارة الصحة والتي تمنح لمرة واحدة حسي تعليمات الوزارة ولكن قلتر الله وفقد الجزء الخارجي منها. وللظروف المعاشية الصعبة التي لا تخص على معاليكم وارتفاع سعر القوقعة في الأسواق المحلية يرجى تفضل معاليكم بالموافقة على استثنائنا من التعليمات وتجهيزنا بقوقعة جديدة.

شاكرين لمعاليكم تفهمكم وحرصكم على خدمة أبناء العراق وخاصة الأطفال منهم سائلين

المولى عز وجل ان يوفقكم لما يحب ويرضى.

وتقبلوا فائق الاحترام





المواطن



سعد إبراهيم عجاج



Last name: al saad Ibrahim Age: 21 months Date of test: 21-02-2024
 First name(s): d Day of birth: 09-05-2022
 Address: _____ Tel: _____
 E-Mail: _____
 Examiner: ADM

Curve	Replayed Rejected	Reject Int. (µV)	Masking	Wave Pages	Stimuli sec	Display		Ratio Resp. Ampl. dB	Polarity	Window	Freq.	Sine waves	Rise/ Fall	Plateau
						Low Pass	High Pass							
90 R HPF: 33 Hz Block LPF: 1500 Hz Insert phone Bayesian	4000 0%	[+40] ±40	—	51 %	45.1	None	25Hz	— 55nV	Alter	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
90 L HPF: 33 Hz Block LPF: 1500 Hz Insert phone Bayesian	4000 0%	[+40] ±40	—	74 %	45.1	None	25Hz	— 59nV	Alter	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
80 R HPF: 33 Hz Block LPF: 1500 Hz Insert phone Bayesian	4000 0%	[+40] ±40	—	40 %	45.1	None	25Hz	— 73nV	Alter	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
80 L HPF: 33 Hz Block LPF: 1500 Hz Insert phone Bayesian	4000 0%	[+40] ±40	—	62 %	45.1	None	25Hz	— 60nV	Alter	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
75 R HPF: 33 Hz Block LPF: 1500 Hz Insert phone Bayesian	4000 0%	[+40] ±40	—	30 %	45.1	None	25Hz	— 64nV	Alter	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
75 L HPF: 33 Hz Block LPF: 1500 Hz Insert phone Bayesian	4000 0%	[+40] ±40	—	20 %	45.1	None	25Hz	— 60nV	Alter	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
70 R HPF: 33 Hz Block LPF: 1500 Hz Insert phone Bayesian	4000 0%	[+40] ±40	—	19 %	45.1	None	25Hz	— 64nV	Alter	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
70 L HPF: 33 Hz Block LPF: 1500 Hz Insert phone Bayesian	4000 0%	[+40] ±40	—	0 %	45.1	None	25Hz	— 60nV	Alter	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

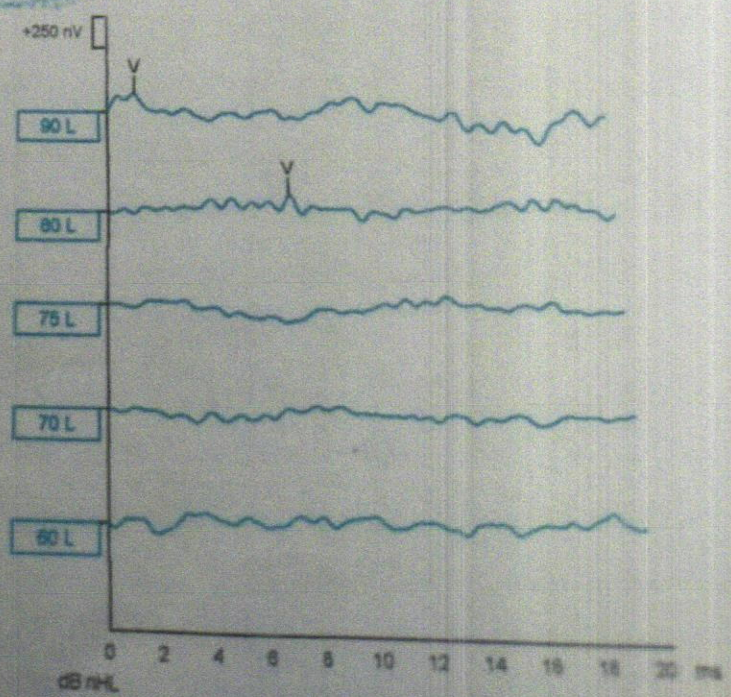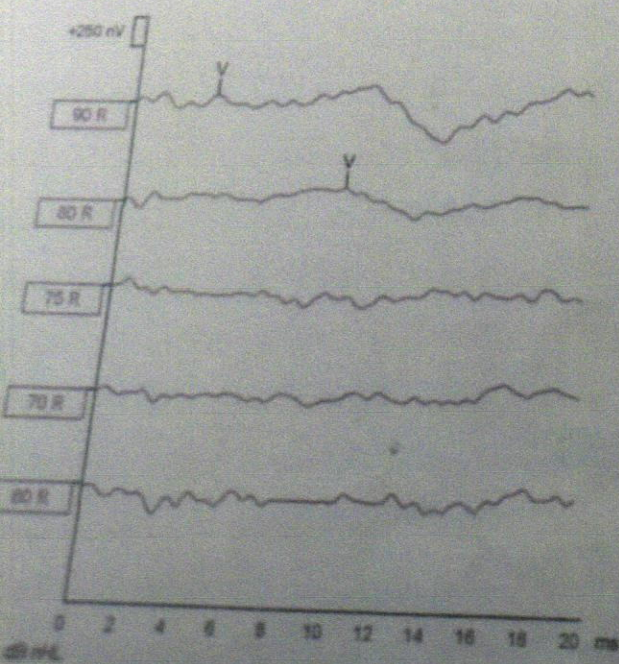

name of used protocol: Threshold Click - Filtered at: 21-2-2024 10:31:10

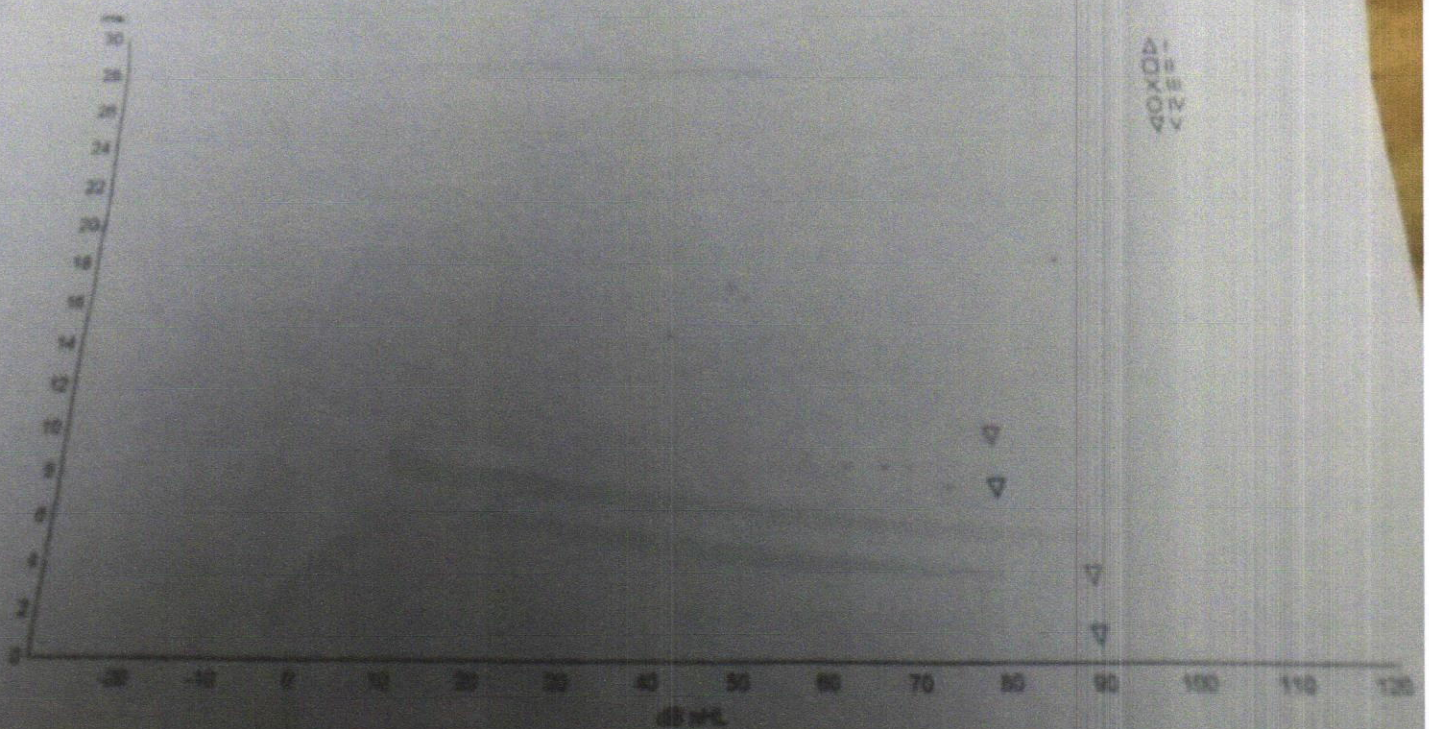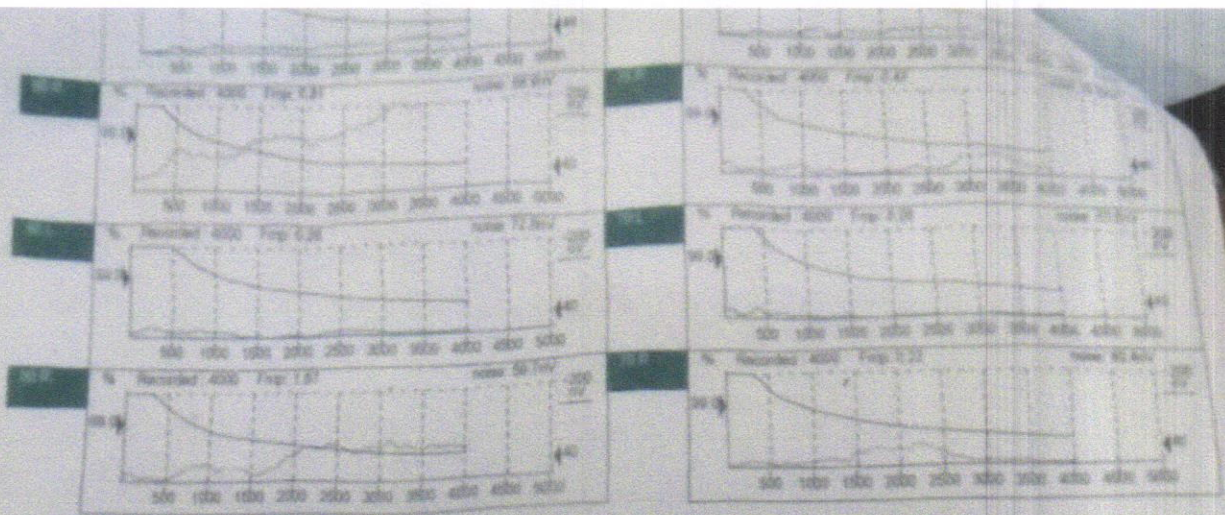

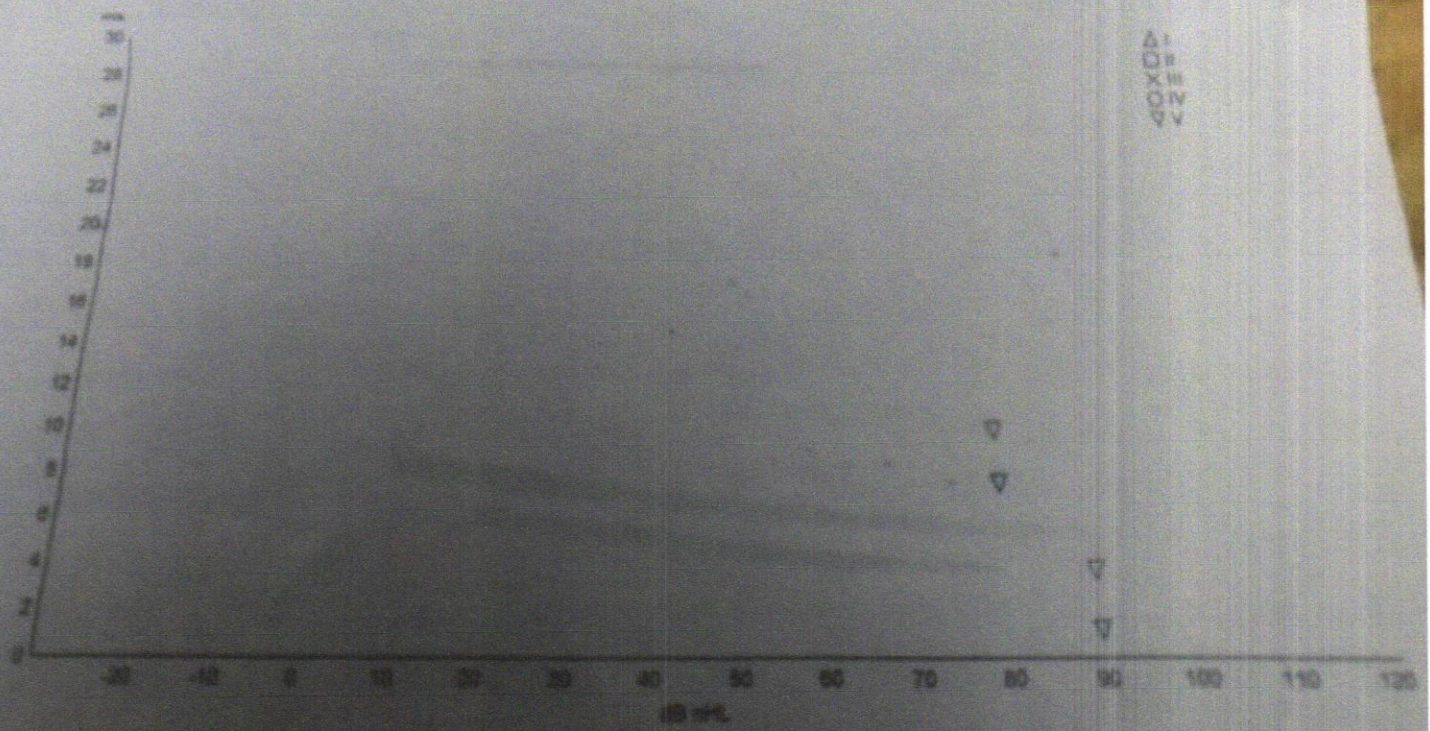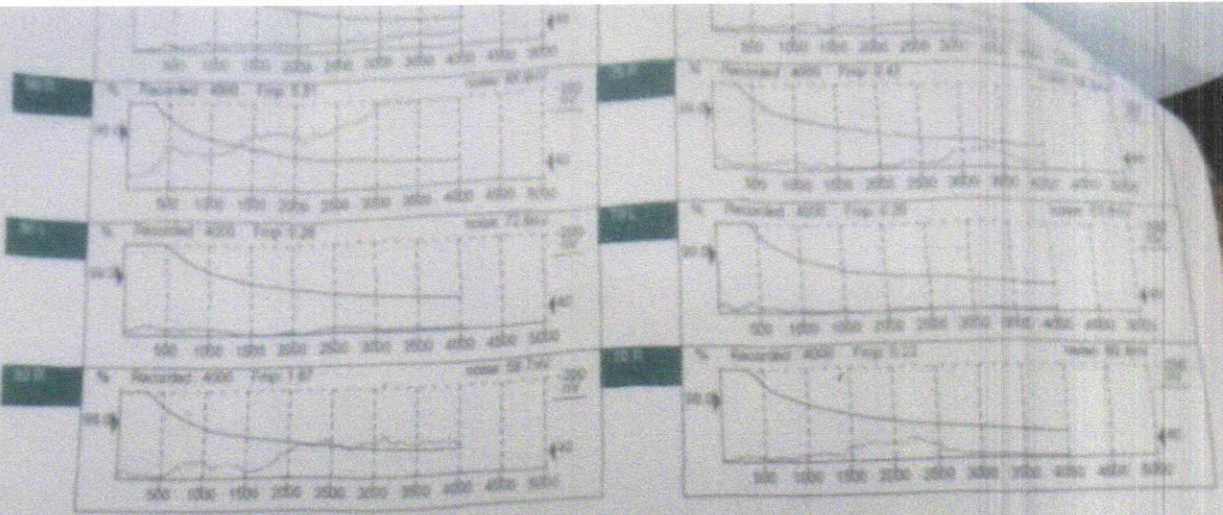

Δ
○
X
○
▽

